

12





13



14

MOVIMIENTO (PLM)

- Colocar el sensor en el tobillo o en la muñeca **(12)**.
- Asegurar el cable con esparadrapo hipoalérgico **(12)**.
- Conectar a la entrada "Aux" del equipo de **color gris claro (12 a)** y **(8)**.

INICIO PRUEBA (MODO MANUAL)

- Mantener presionado el botón ⏻ de encendido/apagado del equipo hasta que éste se ponga en marcha **(13)**.
- Presionar el joystick para iniciar la prueba. Una luz bajo la pantalla comenzará a parpadear para confirmar que la prueba se ha iniciado **(14)**.

FIN PRUEBA (MODO MANUAL)

- Mantener presionado el botón de encendido-apagado del equipo hasta que aparezca el mensaje **"APAGANDO EQUIPO" (13)**.

INICIO Y FIN PRUEBA (MODO AUTOMÁTICO)

- El equipo puede programarse para iniciar y finalizar la prueba a una hora determinada. En ese caso el inicio y fin de la prueba será automático.

El paciente debe leer o ser informado de las advertencias y precauciones descritas en el manual de uso.

En las pruebas a domicilio, es muy recomendable que la colocación de los sensores la realice personal sanitario. Si la realiza el propio paciente, en caso de dudas contactar con el personal sanitario.

Durante la realización de la prueba en el domicilio, el paciente sólo debe dormir con la máxima normalidad posible. No hay alarmas ni situaciones que obliguen a contactar con el personal sanitario, durante la realización de la misma.

CONDICIONES AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- El equipo debe **transportarse** mediante el maletín proporcionado y dentro de las condiciones: T: de -20 a 60 ºC. H: <90% sin condensación
- Las condiciones de **uso** deben ser:
  T: de 5 a 40 ºC. H: de 15 a 90% sin condensación
  P: de 700 a 1060 hPa (de 3000 a -380 m aprox.)

INSTRUCCIONES ADICIONALES

CE 0318 Producto clase IIa según el Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745.

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com


534-7AB-GR1 Rev. 2.01 · 2024-05

www.sibelmed.com

Guía rápida






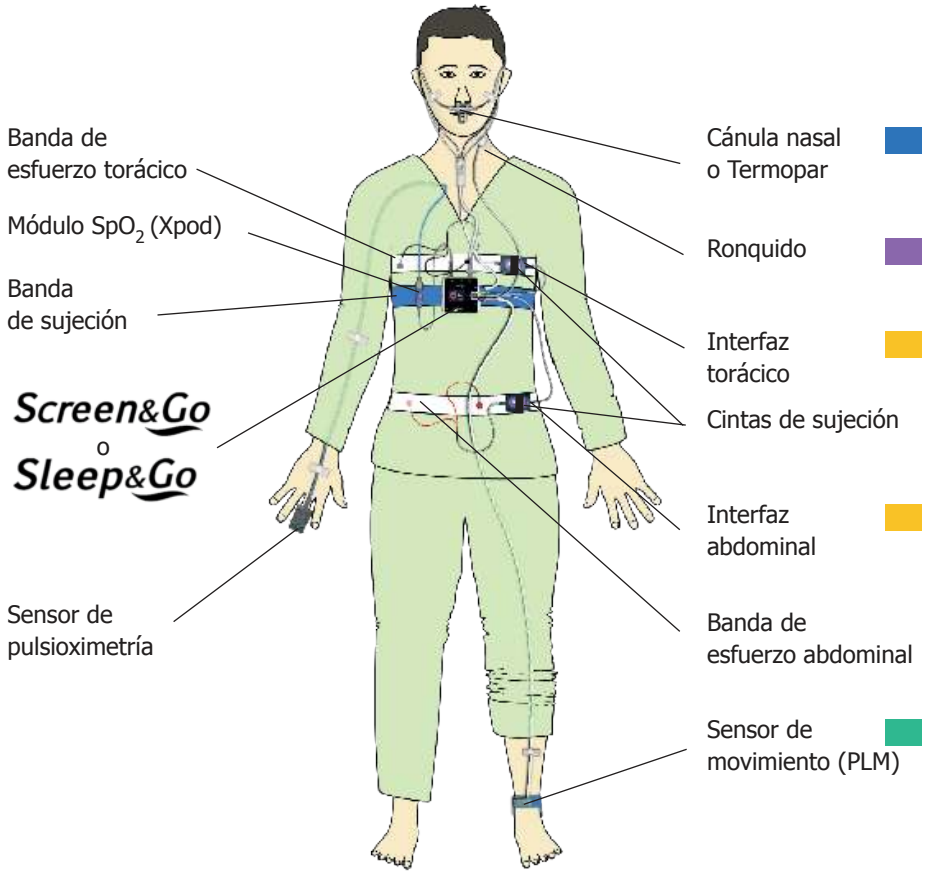

Pendrive Manual de uso incluido en formato PDF. Solicite copia impresa si es necesario.


www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

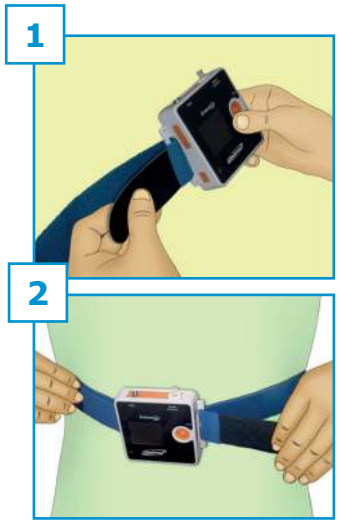


BANDA DE SUJECIÓN


- Pasar la banda de sujeción por el lateral del equipo, doblándola y pegándola sobre sí misma **(1)**.
- Colocar el equipo entre el abdomen y tórax y pasar la banda alrededor del cuerpo.
- Pasar el otro extremo de la banda por el otro lateral del equipo y ajustarlo de forma que quede firmemente sujeto **(2)**.

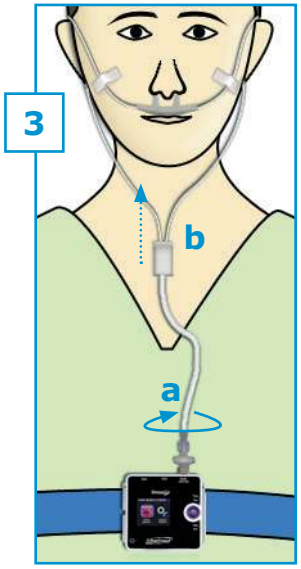

CÁNULA NASAL

- Colocarse la cánula nasal como se muestra en la imagen **(3)**. Utilizar esparadrapo hipoalérgico para sujetar la cánula a la mejilla.
- Conectar a la entrada del equipo "Nasal cannula" y girar hasta que la conexión sea segura **(3a)**.
- Ajustar por debajo de la barbilla **(3b)**.

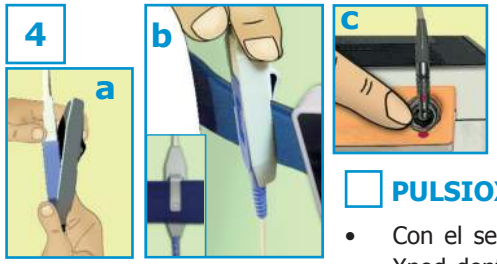

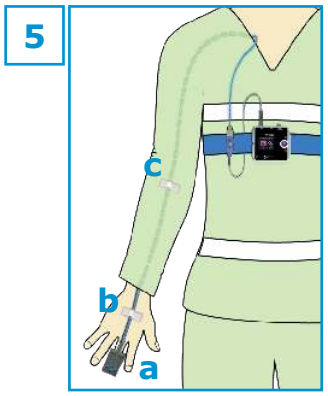


PULSIOXIMETRÍA

- Con el sensor (dedal) conectado el Xpod, colocar el Xpod dentro de la pinza **(4a)** y sujetarlo a la banda con el cable largo del sensor saliendo hacia arriba **(4b)**.
- Conectar el cable corto del Xpod a la entrada "SpO_2" del equipo, haciendo coincidir las marcas rojas **(4c)**.
- Introducir el dedo índice o corazón en el sensor hasta el tope sin que sobresalga **(5a)**.
- Fijar el cable con esparadrapo sobre la mano y el antebrazo **(5b y 5c)**.

Nota:

- Es aconsejable que el cable se situe a lo largo del brazo, por la parte interior del pijama.

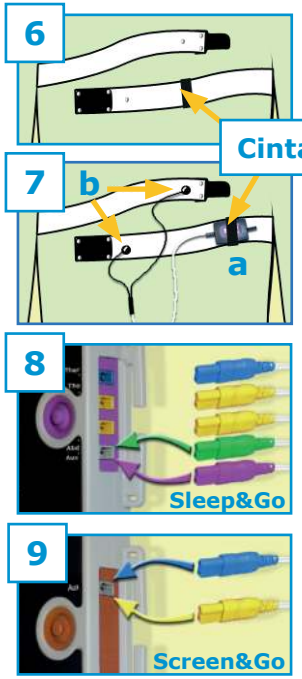


BANDAS DE ESFUERZO

- Ajustarse las bandas alrededor del tórax y/o abdomen, habiendo pasado previamente las cintas de sujección **(6)**. Sujetar la caja "Chest" (Interfaz torácico) sobre la banda torácica con el velcro y asegurar con la cinta **(7a)**.
- Proceder de la misma forma con la caja "Abd" (Interfaz abdominal) sobre la banda abdominal.
- Conectar los bornes tipo "clip" a los corchetes (tetones) de la banda correspondiente **(7b)**.
- Conectar las cajas ("Chest" y/o "Abd") a las entradas del equipo "Tho" y/o "Abd" de **color amarillo** **(8)**.


Nota:

- Para el Screen&Go, conectar la caja ("Chest" o "Abd) a la entrada "Aux" del equipo de **color gris claro** **(9)**.

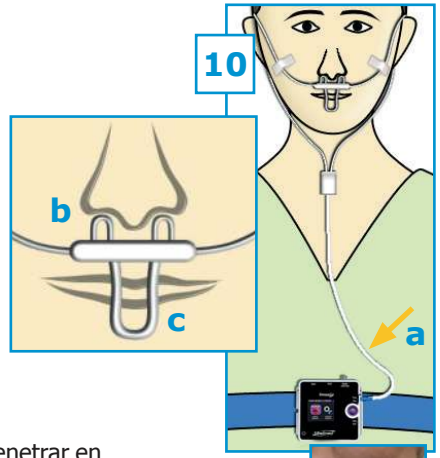

FLUJO TERMOPAR

- Colocar el sensor termopar sobre el labio superior. Doblar las sondas nasales **(10b)** para que los extremos queden enfrentados al orificio nasal sin tocar la piel. Sujetar los cables a las mejillas con esparadrapo hipoalérgico **(10)**.
- Doblar la sonda oral **(10c)** frente a la boca sin penetrar en ella ni tocar la piel o los labios.
- Conectar el sensor a la entrada del equipo **(10a)**:
  - "Ther" de **color azul** para el Sleep&Go **(8)**
  - "Aux" de **color gris claro** para el Screen&Go **(9)**

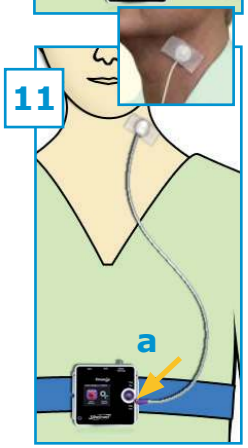

RONQUIDO

- Colocar el sensor en la parte anterior del cuello, no directamente sobre la laringe. Fijar con esparadrapo hipoalérgico **(11b)**.
- Conectar a la entrada "Aux" del Sleep&Go de **color gris claro** **(11a)** y **(8)**.

www.sibelmed.com