


12





13

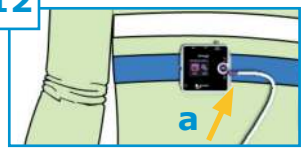

14

MOUVEMENT (PLM)

- Placer le capteur sur la cheville ou le poignet **(12)**.
- Protéger le câble avec du sparadrap hypoallergénique **(12)**.
- Connecter à la voie "Aux" de l'appareil de **couleur gris clair** **(12 a)** et **(8)**.

DÉBUT D'ENREGISTREMENT (MODE MANUEL)

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de marche/arrêt de l'appareil jusqu'à ce qu'il se mette en marche **(13)**.
- Appuyer sur le joystick pour commencer le test. Une lumière sous l'écran commencera à clignoter afin de confirmer que l'enregistrement a débuté **(14)**.

FIN D'ENREGISTREMENT (MODE MANUEL)

- Maintenir appuyé le bouton de marche/arrêt de l'appareil jusqu'à ce qu'apparaisse le message "ARRÊT DE L'APPAREIL" **(13)**.

DÉBUT ET FIN D'ENREGISTREMENT (MODE AUTOMATIQUE)

- L'appareil doit être programmé pour commencer et terminer l'enregistrement à une heure déterminée. Dans ce cas précis, le début et la fin du test **seront automatiques**.

Le patient doit lire ou être informé des avertissements et précautions décrits dans le manuel d'utilisation.

Dans les tests à domicile, il est fortement recommandé que le placement des capteurs soit effectué par du personnel de santé. S'il est fait par le patient lui-même, en cas de doute, contactez le personnel de santé.

Pendant le test à domicile, le patient ne doit dormir que le plus normalement possible. Il n'y a pas d'alarmes ou de situations nécessitant de contacter le personnel de santé, pendant le test.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

- L'appareil doit être **transporté** grâce à la sacoche livrée avec et dans les conditions:
  T: de -20 à 60 ºC. H: <90% sans condensation
- Les conditions d'utilisation doivent être:
  T: de 5 à 40 ºC. H: de 15 à 90% sans condensation
  P: de 700 à 1060 hPa (de 3000 à -380 m aprox.)

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

CE 0318 Produit de classe IIa selon au règlement (UE) 2017/745

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventes nationales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventes internationales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Service technique: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com


534-7AB-GR4 Rev. 2.01 2024-05

www.sibelmed.com

Guide rapide






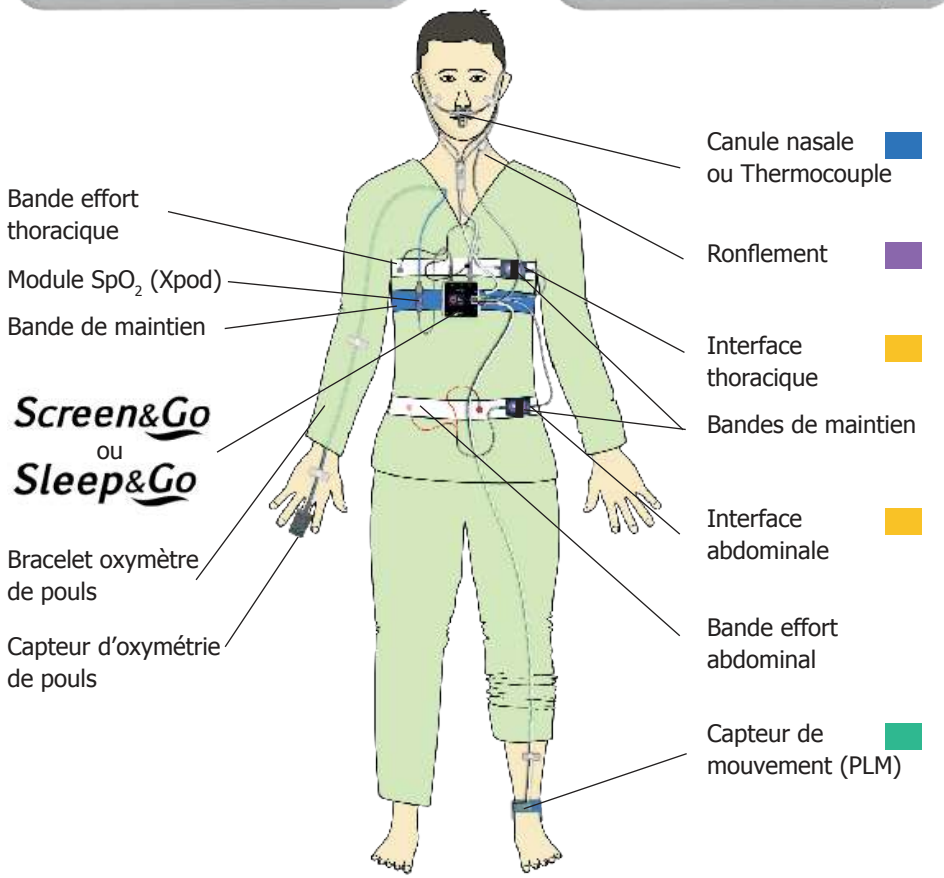

Pendrive Manuel d'utilisation inclus au format PDF. Demandez une copie imprimée si nécessaire.


www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

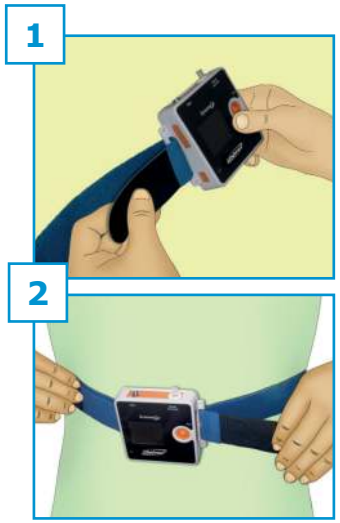


BANDE DE MAINTIEN


- Passer la bande de maintien par le côté de l'appareil en la pliant sur elle même. **(1)**.
- Installer l'appareil entre l'abdomen et le thorax et passer la bande autour du buste.
- Passer l'autre extrémité de la bande par l'autre côté de l'appareil et la régler de manière qu'elle soit bien maintenue **(2)**.

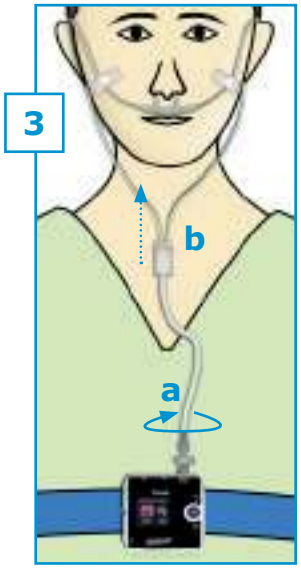

CANULE NASALE

- Installer la canule nasale comme expliqué sur le dessin **(3)**. Utiliser du sparadrap hypoallergénique afin de maintenir la canule aux joues.
- Connecter à l'entrée de l'appareil "Nasal cannula" et visser afin que la connexion soit complète **(3a)**.
- Régler la longueur par le bas sous le menton **(3b)**.

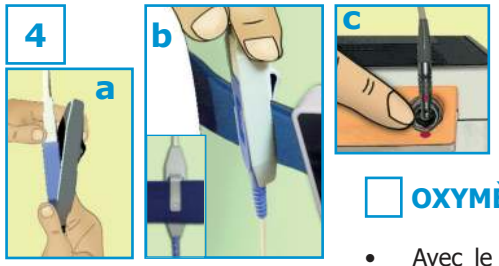

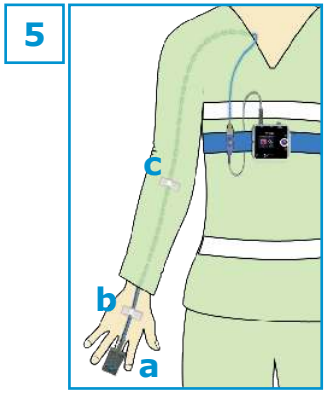


OXYMÈTRE DE POULS

- Avec le capteur (capteur doigt souple) connecté au Xpod, l'introduire dans la pince **(4a)** et l'attacher à la bande, avec le câble long positionné ver le haut **(4b)**
- Connecter le câble court au Xpod au connecteur "SpO_2" de l'appareil, tout en faisant coïncider les marques rouges **(4c)**.
- Insérer l'index ou le majeur dans le capteur jusqu'à la limite **(5a)**.
- Fixer le câble avec du sparadrap sur la main et l'avant-bras **(5b et 5c)**.

Note:

- Il est conseillé de positionner le câble le long du bras à l'intérieur du pyjama.

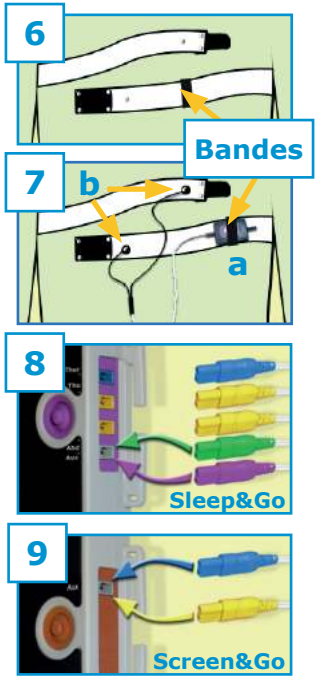


BANDES D'EFFORT

- Régler les bandes autour du thorax et/ou abdomen en ayant auparavant introduit les bandes de maintien **(6)**.
- Positionner le boîtier "Chest" (Interface thoracique) sur la bande thoracique avec du velcro et la maintenir grâce à la bande **(7a)**.
- Procéder de la même manière pour le boîtier "Abd" (Interface abdominale) sur la bande abdominale.
- Connecter les boutons pression de type "clip" des câbles à ceux présents sur chaque bande **(7b)**.
- Connecter les boîtiers ("Chest" y/o "Abd") aux entrées de l'appareil "Tho" et/ou "Abd" de **couleur jaune** **(8)**.

Note:

- Pour le Screen&Go, connecter le boîtier ("Chest" ou "Abd) a l'entrée "Aux" de l'appareil de **couleur gris clair** **(9)**.

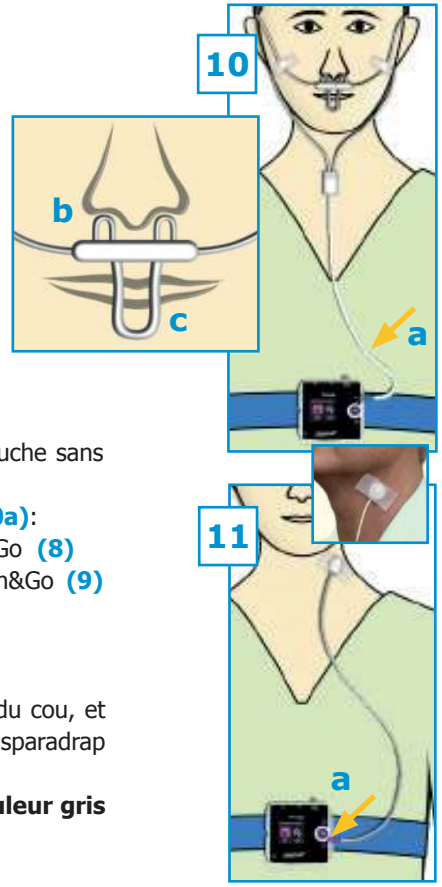

FLUX THERMOCOUPLE

- Mettre le capteur thermocouple sur la lèvre supérieure. Doubler les sondes nasales **(10b)** afin que les extrémités soient en face des fosses nasales sans toucher la peau. Maintenir les câbles à la joue avec du sparadrap hypoallergénique **(10)**.
- Doubler la sonde orale **(10c)** en face de la bouche sans toucher ni la peau ni les lèvres.
- Connecter le capteur à l'entrée de l'appareil **(10a)**:
  - "Ther" de **couleur bleue** pour le Sleep&Go **(8)**
  - "Aux" de **couleur gris clair** pour le Screen&Go **(9)**

RONFLEMENT

- Positionner le capteur sur la partie antérieure du cou, et non pas directement sur le larynx. Fixer avec du sparadrap hypoallergénique **(11b)**.
- Connecter à l'entrée "Aux" du Sleep&Go de **couleur gris clair** **(11a)** et **(8)**.

www.sibelmed.com