

12





13



14

MOVIMIENTO (PLM)

- Posizionare il sensore sulla caviglia o al polso **(12)**.
- Fissare il cavo con un nastro adesivo ipoallergenico **(12)**.
- Collegare il connettore di colore **grigio chiaro** all'ingresso "Aux" **(12 a)** e **(8)**.

AVVIO DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)

- Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento ⏻ fino a quando il dispositivo non si accende **(13)**.
- Premere il joystick per avviare il test. Una spia sotto lo schermo inizierà a lampeggiare per confermare l'avvio del test **(14)**.

TERMINE DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)

- Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non appare il messaggio **"ARRESTO DEL DISPOSITIVO" (13)**.

AVVIO E TERMINE DEL TEST (MODALITÀ AUTOMATICA)

- Il dispositivo può essere programmato per iniziare e terminare il test ad un'ora specifica. In tal caso, l'avvio e il termine del test saranno automatici.

Il paziente deve leggere o essere informato delle avvertenze e precauzioni descritte nel manuale utente.

Nei test domiciliari, si raccomanda vivamente che il posizionamento dei sensori sia effettuato da personale sanitario. Se lo fa il paziente stesso, in caso di dubbio contattare il personale sanitario.

Nei test domiciliari, si raccomanda vivamente che il posizionamento dei sensori sia effettuato da personale sanitario. Nel caso in cui sia il paziente ad effettuarlo, contattare il personale sanitario in caso di dubbi, durante il test.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

- Il dispositivo deve essere **trasportato** nella custodia fornita e nelle seguenti condizioni:
  T: da -20 a 60 ºC. U: < 90% senza condensazione
- Le condizioni di **utilizzo** devono essere:
  T: da 5 a 40 ºC. U: da 15 a 90% senza condensazione
  P: da 700 a 1060 hPa (da 3000 a -380 m aprox.)

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE

CE 0318 Prodotto di categoria IIa a Regolamento Europeo sui dispositivi medici (UE) 2017/745

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Uff. vendite nazionali: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Uff. vendite internazionali: Tel.+34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servizio Post-Vendita: Tel.+34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

534-7AB-GR6 Rev. 2.01 2024-05


www.sibelmed.com

Sibelmed®

Guida rapida






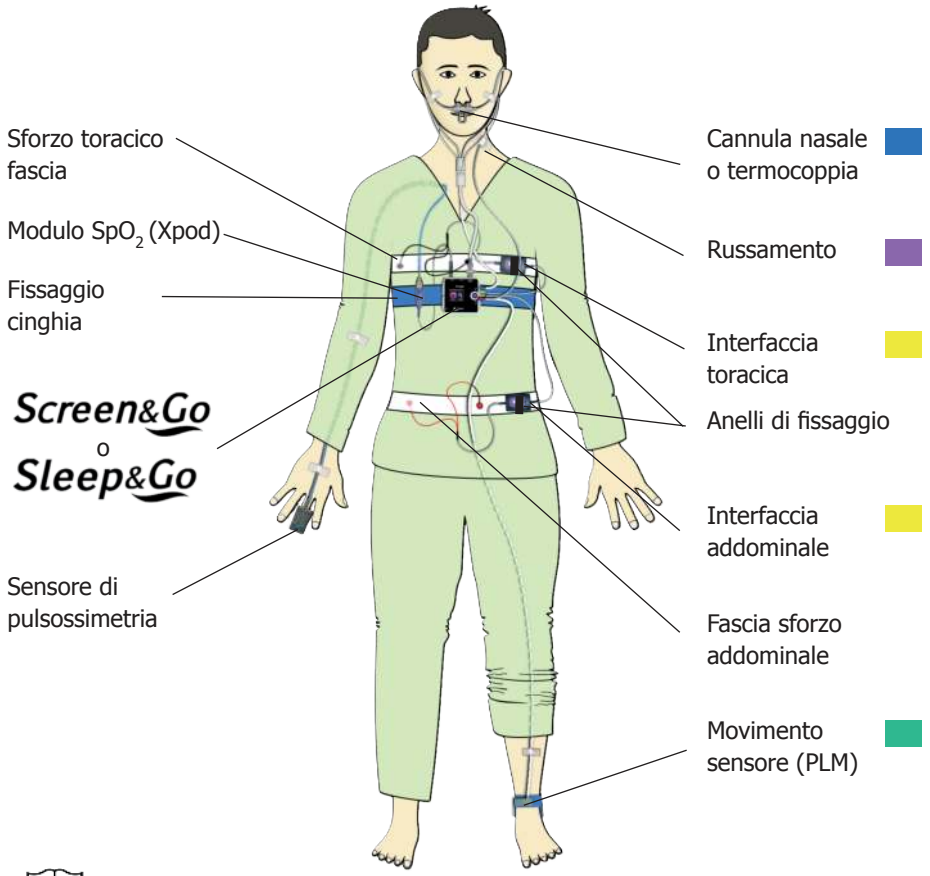

Pendrive Manuale utente incluso in formato PDF. Richiedi una copia stampata se necessario.

www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

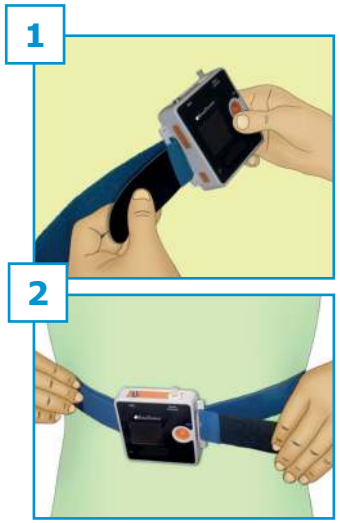



CINGHIA DI FISSAGGIO


- Far passare la cinghia di fissaggio a lato del dispositivo, piegandola e attaccandola su se stessa **(1)**.
- Posizionare il dispositivo tra l'addome e il torace e far passare la cinghia intorno al corpo.
- Far passare l'altra estremità della cinghia sull'altro lato del dispositivo e regolarla in modo che sia fissata saldamente. **(2)**.

CANNULA NASALE

- Posizionare la cannula nasale come mostrato nell'immagine **(3)**. Usare del nastro adesivo ipoallergenico per fissare la cannula alle guance.
- Collegare la cannula all'ingresso "Nasal cannula" e ruotarla fino a quando la connessione non è completata **(3a)**.
- Regolare la lunghezza sotto il mento **(3b)**.

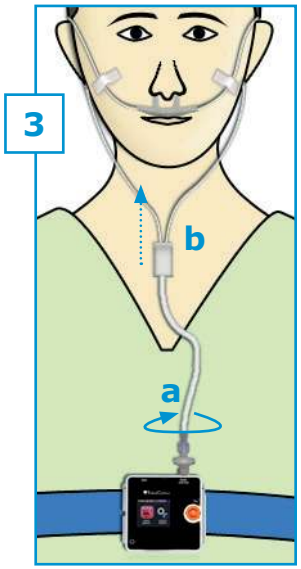

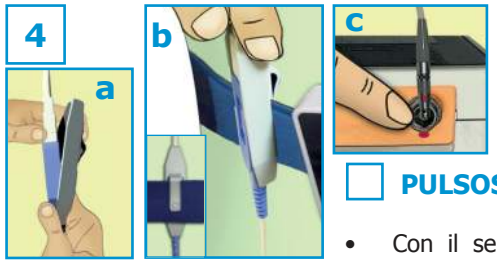

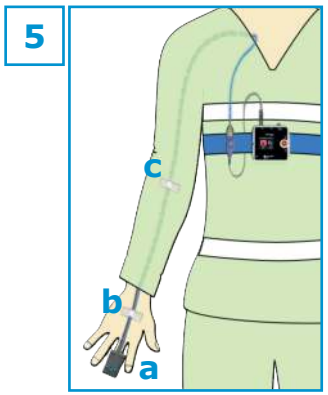


PULSOSSIMETRIA

- Con il sensore di pulsossimetria collegato all'Xpod, agganciare l'Xpod alla clip **(4a)** e attaccarla alla fascia, con il cavo lungo del sensore rivolto verso l'alto **(4b)**.
- Collegare il cavo corto dall'Xpod al connettore "SpO_2" sul dispositivo, in corrispondenza dei due contrassegni rossi **(4c)**.
- Inserire il dito indice o medio nel sensore fino al limite **(5a)**.
- Attaccare il cavo alla mano e all'avambraccio con del nastro adesivo **(5b and 5c)**.

Nota:

- Si raccomanda di posizionare il cavo lungo il braccio all'interno del pigiama.

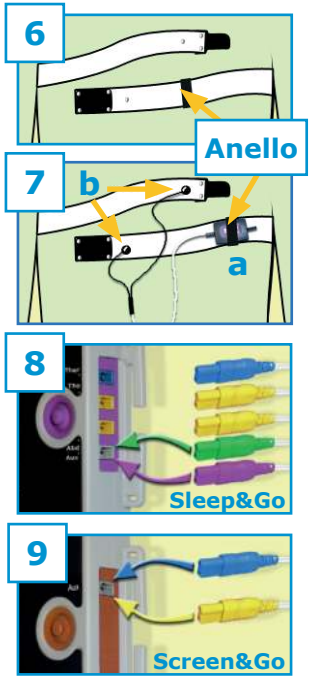


FASCE DI SFORZO

- Regolare le fasce di sforzo intorno al torace e/o addome, dopo aver precedentemente inserito gli anelli di fissaggio **(6)**.
- Posizionare la cassetta "Chest" (interfaccia toracica) sulla banda toracica con il velcro e assicurarla con l'anello di fissaggio **(7a)**.
- Procedere allo stesso modo con la cassetta "Abd" (interfaccia addominale) sulla fascia addominale.
- Collegare i connettori del tipo a "clip" ai supporti della fascia corrispondente **(7b)**.
- Collegare le cassette ("Chest" e/o "Abd") agli ingressi "Tho" e/o "Abd" dell'apparecchio (**connettore giallo**). **(8)**.


Nota:

- Per lo Screen&Go, collegare la cassetta ("Chest" o "Abd") all'ingresso "Aux" (**connettore grigio chiaro**) **(9)**.

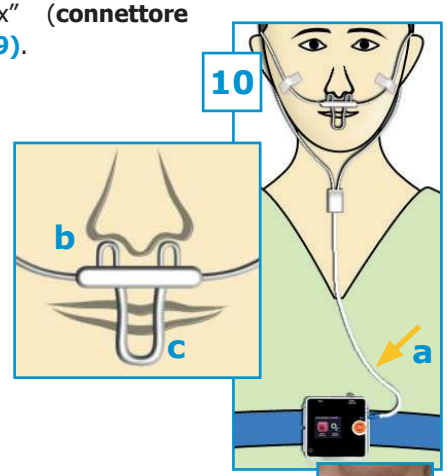

FLUSSO TERMOCOPPIA

- Posizionare il sensore a termocoppia sul labbro superiore. Piegare i le sonde nasali **(10b)**, in modo che le estremità siano rivolte verso le narici, ma senza toccare la pelle. Fissare i cavi alle guance con del nastro adesivo ipoallergenico **(10)**.
- Piegare la sonda orale **(10c)** di fronte alla bocca, senza toccare la pelle o le labbra.
- Collegare il sensore all'ingresso del dispositivo **(10a)**:
  - "Ther" **(connettore blu)** per lo Sleep&Go **(8)**
  - "Aux" **(connettore grigio chiaro)** per lo Screen&Go **(9)**

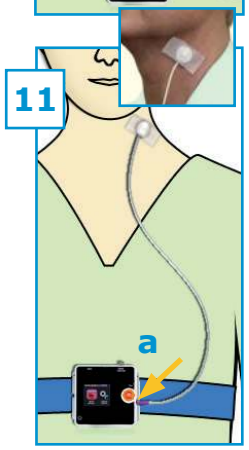

RUSSAMENTO

- Posizionare il sensore sulla parte del collo sotto la guancia (non direttamente sopra la laringe).
- Fissare con nastro adesivo ipoallergenico **(11b)**.
- Collegare il sensore all'ingresso "Aux" (**connettore grigio chiaro**) **(11a)** and **(8)**.

www.sibelmed.com