Sibelmed®

Screen&Go

CRIBADO DEL SAHS

CE0318

Polígrafo de screening para un diagnóstico simplificado del sueño.



Polígrafo domiciliario

8 canales

Señales a tiempo real en pantalla

Apto para pediatría

Recomendaciones de la AASM y GES

Screen&Go · cribado del SAHS

El Screen&Go es un polígrafo de screening de 8 canales de tipo IV que registra las señales necesarias para un diagnóstico sencillo, rápido y fiable en la realización de pruebas de sueño domiciliarias.

Ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBELMED, cumpliendo con las recomendaciones de la AASM y del GES.



≥ 5 años

- Robusto y ligero
- Pantalla gráfica
  a color
- Control de calidad
  de las señales en pantalla
- Hasta 7 canales
  simultáneos



- Información del estado
  del equipo en pantalla
- Apto para pediatría
- Software BitmedLab
  incluido
- Canal de posición
  integrado

CANAL DE POSICIÓN INTEGRADO:

Screen&Go cuenta con un sensor interno que registra información de la posición corporal del paciente y de la actigrafía.



TIEMPO REAL EN PANTALLA:

Permite visualizar a tiempo real en pantalla las señales que se están registrando. Así, el paciente podrá asegurarse de que tiene todos los canales correctamente conectados.



PRUEBAS PROGRAMABLES DESDE EL PC Y EL EQUIPO:

Se pueden programar hasta 5 pruebas consecutivas, desde el propio equipo o en el PC, mediante el software BitmedLab.



MEMORIA DE ILIMITADAS NOCHES:

Puedes almacenar tantas noches como quieras ya que no tiene límite de memoria, porque las pruebas se guardan en una tarjeta de memoria Micro SD externa.



Canales

Flujo por cánula nasal
Ronquido por cánula nasal
Termopar
Banda inductiva torácica
SpO_2
Pulso (BPM)
Posición
Actividad

Eventos

Apneas (obstructiva, central y mixta)
Hipopneas
Desaturación
Ronquido
Limitación al flujo

Sibelmed®

Screen&Go · cribado del SAHS

Software BitmedLab

Screen&Go incorpora de serie BitmedLab, un software de diagnóstico de sueño sencillo e intuitivo para la visualización y revisión de las señales de sueño y el análisis de los eventos respiratorios.

BitmedLab cumple con las recomendaciones de la AASM y es compatible con toda la gama de poligrafía de SIBELMED:

Detección automática
Del equipo enlazado

Múltiples opciones de visualización
Como el color y amplitud de los trazados, configurar marcas de eventos, agregar notas...

Gráfica de severidad IAH
En informes



Informe personalizado
Del estudio de sueño


Base de datos integrada
Para la gestión de pacientes y pruebas

Exportación de datos
En PDF y XML


Sistema operativo
Windows, 7, 8.1, 10 y 11



Pantalla inicial

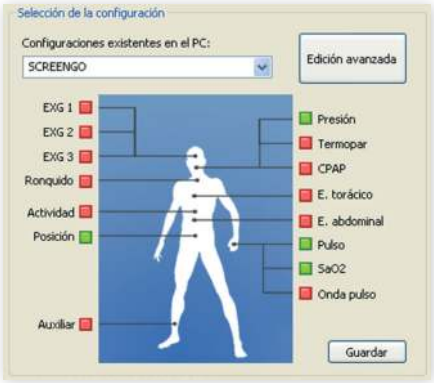


Configuración de los canales

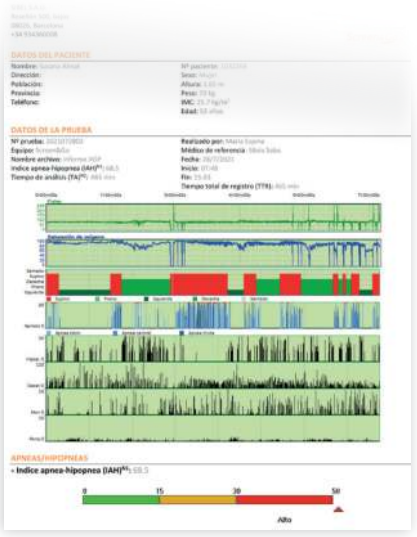

Informe gráfica IAH

ANÁLISIS DE EVENTOS MANUAL O AUTOMÁTICO:
El técnico puede marcar manualmente los eventos o utilizar la función de análisis automático del software, que indicará automáticamente los eventos detectados durante el estudio de sueño.

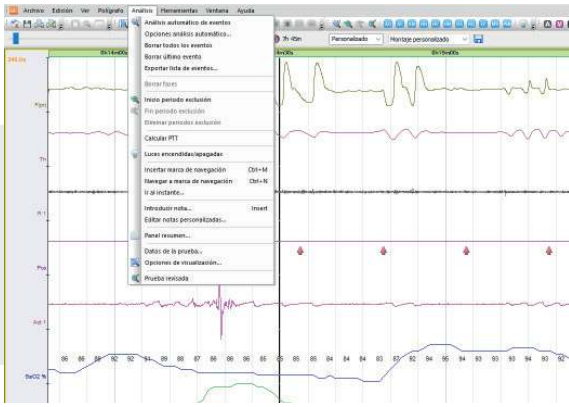

Screen&Go · cribado del SAHS

Especificaciones técnicas

Tipo	Polígrafo de tipo IV
Nº Canales	1-8 (7 simultáneos)
Dimensiones	86 x 86 x 24 mm.
Peso	125 gr (sin pilas)
Batería interna	2 pilas AA alcalinas/recargables NiMH.
Autonomía	4 estudios de 8 horas
Memoria	Micro SD. Máximo 2Gb (>1500 estudios de 8 horas) Micro SD HC. Máximo 16 Gb (>12000 estudios de 8 horas)



Modelos

Screen&Go Configuración A CANALES	Screen&Go Configuración B CANALES
Flujo por cánula nasal	Flujo por cánula nasal
Ronquido por cánula nasal	Ronquido por cánula nasal
SpO_2	SpO_2
Pulso (BPM)	Pulso (BPM)
Canal posición	Canal posición
Canal actividad	Canal actividad
--	Banda torácica

Estándar

20021 Screen&Go Conf. A:
Incluye: Screen&Go (09895), Flujo por cánula, Ronquido por cánula (08078), Canal posición (08079), canal actividad (08080), Modulo pulsioximetría Xpod (09898), Sensor Pulsioximetría Soft (08955), Soporte Xpod (08556), Canal de actividad (08080).

20022 Screen&Go Conf. B:
Incluye: Screen&Go (09895), Flujo por cánula, Ronquido por cánula (08078), Modulo pulsioximetría Xpod (09898), Sensor Pulsioximetría Soft (08955), Soporte Xpod (08556), Canal posición (08079), Canal actividad (08080), Interfaz de ampliación banda inductiva esfuerzo torácico (06314), Banda inductiva elástica extra grande (XL) (01420), Anilla sujeción (07678), Activacióndel canal esfuerzo torácico (09981)

06312 Banda sujeción grande (L)
08060 Tarjeta de memoria SD con adaptador SD
08094 Lector tarjetas memoria USB para PC
03673 2 pilas alcalinas AA 1.5
08010 Maletín de transporte
Manual de uso y guía rápida Screen&Go

Opcionales

06309 Sensor Termopar y activación del canal (09880)
08049 Cánula nasal desechable
06311 Banda de sujeción tamaño pequeño (S)
06313 Banda de sujeción tamaño extra grande (XL)
01424 Banda inductiva elástica tamaño mediana (M)
01425 Banda inductiva elástica tamaño pequeña (S)
01421 Banda inductiva elástica tamaño grande (L)
01420 Banda inductiva elástica tamaño extra grande (XL)
01417 Banda inductiva elástica tamaño extra extra grande (XXL)
08956 Sensor de pulsioximetría pediátrico

Sleep&Go



Polígrafo cardiorrespiratorio

Tipo III de 16 canales para un diagnóstico avanzado del sueño: Flujo respiratorio por cánula nasal, ronquido por cánula nasal, termopar, banda inductiva torácica, SpO2, Pulso (BPM), posición, actividad, nivel de CPAP, banda inductiva abdominal, movimiento de extremidades, ronquido externo, módulo externo ExG (3 canales), onda pulso y Bluetooth (tiempo real).


Positional Therapy somnibel®



Tu solución para las apneas y ronquidos posicionales

Terapia postural que, adherida a la frente, aplica una suave vibración mientras el paciente duerme en supino para inducirle a cambiar de posición, reduciendo la incidencia de apneas del sueño y/o ronquidos posicionales.

Dispositivo SomnibelPro:
Incluye SomniLab, el software para que el profesional analice las noches del paciente.

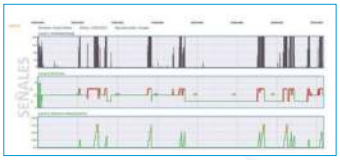

SIBEL,S.A.U. Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelgroup.com
Ventas Internacionales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelgroup.com
Serv. Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelgroup.com
www.sibelmed.com

Producto conforme con:
Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745
EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016+A11:2021

SIBEL,S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin necesidad de previo aviso.

Sibelmed

FG BIT 1201 - Screen&Go - V.2.0 - 05/2024